



証明書番号第 250282 号

証 明 書

令和7年9月2日

特定計量器 住 所
の 使用 者 仙台市青葉区星陵町1-1

氏 名(名称及び代表者の氏名)

東北大学病院臨床研究推進センター 臨床研究実施部門 殿

計量法第23条の規定に従って検査を行い、
ここに合格と認めます。

1. 検査を行った特定計量器の種類

特定計量器の種類	能力	台数	器物番号	備考
電気抵抗線式はかり	200kg	1台	No. 3A6003724	

以下余白

2. 検査を行った年月日

令和7年8月5日

3. 検査を行った場所

住所に同じ

令和7年9月2日

検査を行った計量士の氏名
及び登録番号

斎藤 晴海

第12326号



仙台市太白区長町七丁目22番23号

仙台市指定定期検査機関

一般社団法人 宮城県計量協会



検査用実用基準分銅一覧表

種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	管理番号	種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	管理番号
1級実用基準分銅	10kg	88-1	枕型	ステンレス	K03	1級実用基準分銅	10kg	88-16	枕型	ステンレス	K09
1級実用基準分銅	10kg	88-2	枕型	ステンレス	K03	1級実用基準分銅	10kg	88-17	枕型	ステンレス	K09
1級実用基準分銅	10kg	88-3	枕型	ステンレス	K03	1級実用基準分銅	10kg	88-18	枕型	ステンレス	K09
1級実用基準分銅	10kg	88-4	枕型	ステンレス	K03	1級実用基準分銅	10kg	88-19	枕型	ステンレス	K09
1級実用基準分銅	10kg	88-5	枕型	ステンレス	K09	1級実用基準分銅	10kg	88-20	枕型	ステンレス	K09
1級実用基準分銅	10kg	88-6	枕型	ステンレス	K09						
1級実用基準分銅	10kg	88-7	枕型	ステンレス	K09						
1級実用基準分銅	10kg	88-8	枕型	ステンレス	K09						
1級実用基準分銅	10kg	88-9	枕型	ステンレス	K09						
1級実用基準分銅	10kg	88-10	枕型	ステンレス	K09						
1級実用基準分銅	10kg	88-11	枕型	ステンレス	K09						
1級実用基準分銅	10kg	88-12	枕型	ステンレス	K09						
1級実用基準分銅	10kg	88-13	枕型	ステンレス	K09						
1級実用基準分銅	10kg	88-14	枕型	ステンレス	K09						
1級実用基準分銅	10kg	88-15	枕型	ステンレス	K09						
種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	管理番号	種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	管理番号
1級実用基準分銅	5kg	88-31	枕型	ステンレス	K10	1級実用基準分銅	5kg	88-32	枕型	ステンレス	K10
種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	備考	種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	管理番号
1級実用基準分銅	2kg	13-1	円筒型	真ちゅう	K06	1級実用基準分銅	2kg	14-2	枕型	ステンレス	K07
1級実用基準分銅	2kg	13-2	円筒型	真ちゅう	K06	1級実用基準分銅	2kg	14-3	枕型	ステンレス	K07
1級実用基準分銅	2kg	14-1	枕型	ステンレス	K07	1級実用基準分銅	2kg	14-4	枕型	ステンレス	K07
種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	管理番号	種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	管理番号
2級実用基準分銅	2kg	90-1	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	200g	90-4	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	2kg	90-2	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	100g	90-1	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	1kg	90-1	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	100g	90-2	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	1kg	90-2	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	100g	90-3	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	500g	90-1	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	100g	90-4	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	500g	90-2	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	50g	90-1	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	500g	90-3	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	50g	90-2	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	500g	90-4	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	20g	90-1	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	200g	90-1	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	20g	90-2	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	200g	90-2	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	10g	90-1	増おもり型	真ちゅう	K15
2級実用基準分銅	200g	90-3	増おもり型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	10g	90-2	増おもり型	真ちゅう	K15
種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	管理番号	種 類	表す質量	器物番号	形状	材質	管理番号
2級実用基準分銅	50g	90	円筒型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	500mg	90	板状	ステンレス	K15
2級実用基準分銅	20g	90	円筒型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	100mg	90	板状	ステンレス	K15
2級実用基準分銅	10g	90	円筒型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	50mg	90	板状	ステンレス	K15
2級実用基準分銅	5g	90	円筒型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	20mg	90	板状	ステンレス	K15
2級実用基準分銅	2g	90	円筒型	真ちゅう	K15	2級実用基準分銅	10mg	90	板状	ステンレス	K15
2級実用基準分銅	1g	90	円筒型	真ちゅう	K15						

上記の分銅は、基準器検査規則の規定に基づき経済産業大臣が別に定める質量計に係る基準等について(平成27年経済産業省告示第64号)第2条(器差検査に使用する特定標準器又は基準器)に基づき承認された日本産業規格B7611-2(2015)附属書JCに従って校正したものであることを証明します。

2025年8月29日

仙台市太白区長町七丁目22番23号
 仙台市指定定期検査機関
 一般社団法人 宮城県計量協会



計量器検査成績書

No.1

1 申請者

事業所名	東北大学病院臨床研究推進センター臨床研究実施部門
所在地	宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

(1) 計量器の種類及び表記

管理番号	表記なし	器物番号	3A6003724
種類	電気抵抗線式はかり	メーカー	株式会社エー・アンド・デイ
型式	AD-6228AP	最小測定量	2kg
型式承認	第D109号	精度等級	3級
ひょう量	200kg	検定証印等	有(2023年11月)
目量	100g		

(2) 検査項目

①外観		適合		②構造		適合		⑤繰り返しの試験		適合										
③器差の試験				適合		※検査荷重→ひょう量の約1/4														
荷 重		器 差 (g)				使用公差		50kg												
(kg)		行き		戻り		(g)		1回目		0										
0		0		0		±100		2回目		0										
2		0		0		±100		3回目		0										
10		0		0		±100		単位(g)												
20		0		0		±100														
50		0		0		±100														
100		0		0		±200														
150		0		0		±200														
200		0		↑		±200														
以下余白																				
※器差0とは、目量内にあることを示す。																				
④感じの試験		適合		⑥偏置誤差の試験								適合								
※検査荷重		目量の2倍		※検査荷重→ひょう量の約1/3						70kg										
※検査箇所		最小測定量 ひょう量の1/2 ひょう量		<table><tr><td>0</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>0</td></tr></table>								0		0		0		0		0
0		0																		
	0																			
0		0																		
単位(g)																				
形状:角皿																				

2 検査年月日 2025年8月5日

3 その他 適合とは基準内にあることを示す。

4 総合判定 合格


計量器検査の結果、上記のとおりであることを証明します。

2025年8月29日

宮城県仙台市太白区長町七丁目22番25号
一般社団法人 宮城県計量協会計量士 斎藤 晴海
登録番号 第12362号



質量標準供給体系図

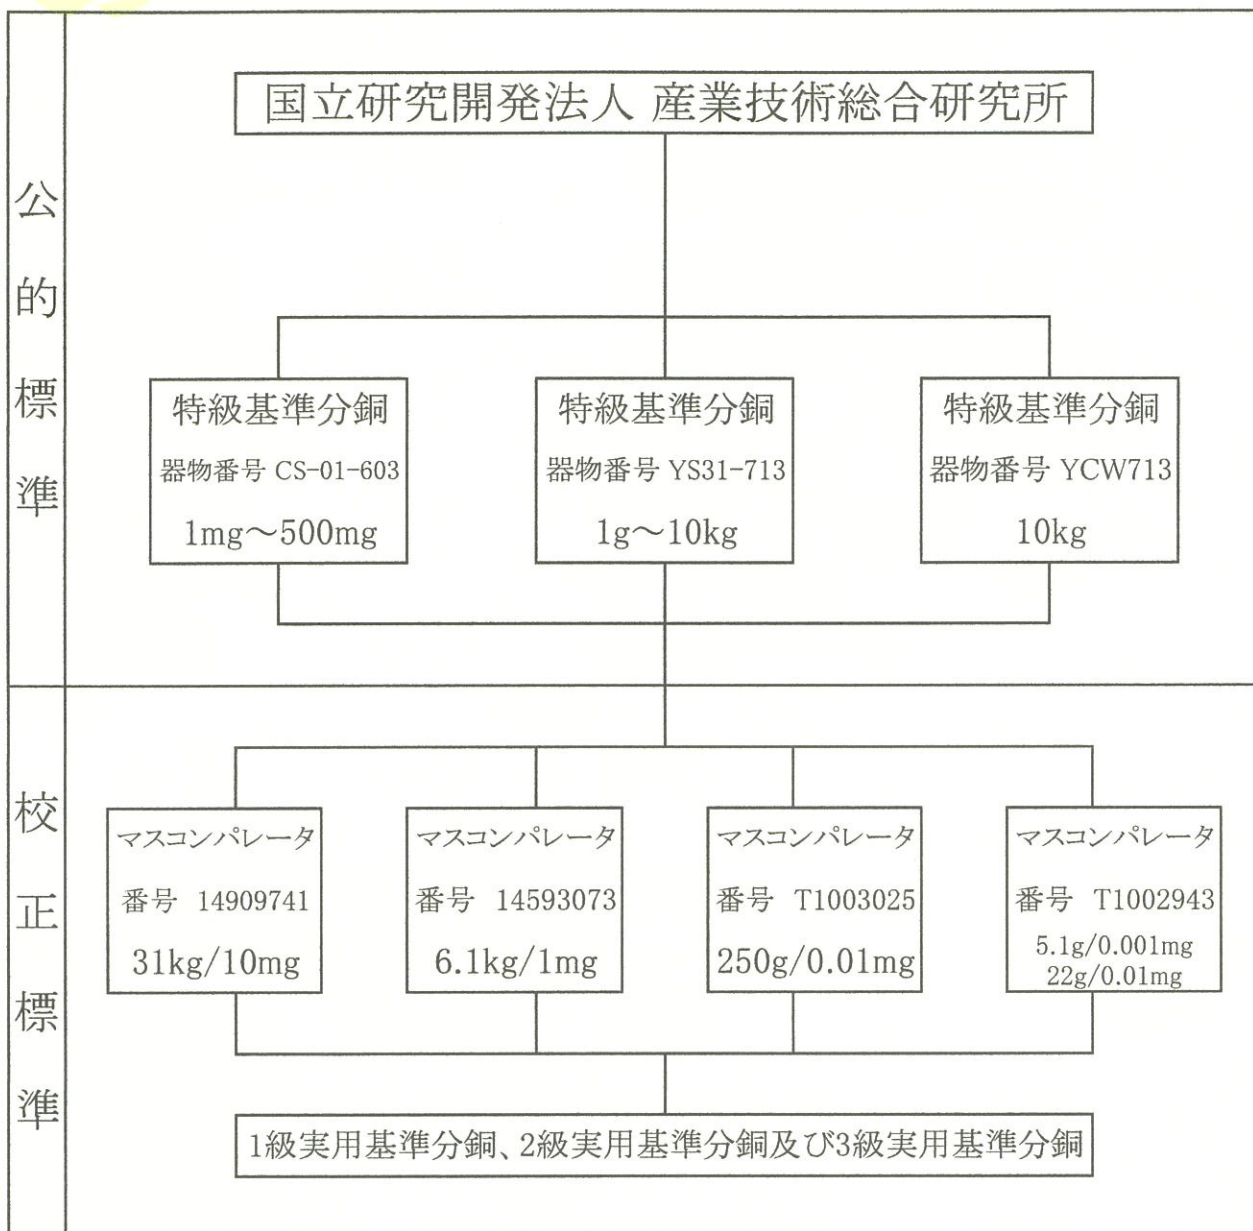

当協会の質量計の定期検査は、上記体系図のとおりである。

2025年8月29日

宮城県仙台市太白区長町七丁目 22-23

仙台市指定定期検査機関

一般社団法人 宮城県計量協会

